Structure des menus

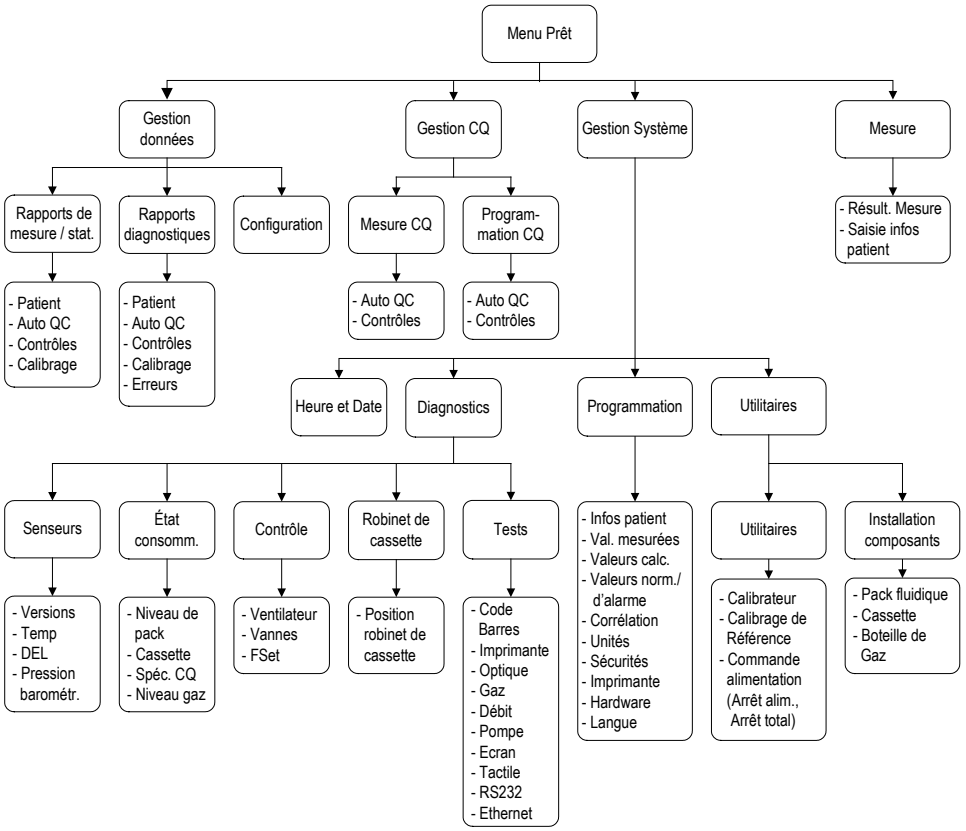

Consommables OPTI R

	Ref/No.
Cassettes E-Ca_{50}	BP7601
Pack fluidique	BP7092
Bouteille de gaz de calibrage	BP7001
Cartouche de pompe péristaltique	BP7118
Cassette de calibrage	BP7535
Papier d'imprimante	HP0070
Adaptateurs de seringue	BP7600
OPTI Check, tri-niveaux	HC7008

Assistance technique

Contactez le distributeur OPTI Medical de votre pays.

© OPTI Medical Systems, Inc 2007 OPTI est une marque déposée d'OPTI Medical Systems, Inc. AT7038-B

OPTIMedical

OPTI® R Mode D'Emploi simplifié

Mesure spécimen patient

Seringue

1. A partir de la page-écran **<Prêt>**, tapez **<Mesure spécimen>**.
2. Placez un nouvel adaptateur rouge à l'entrée de la cassette.
3. Homogénéisez le spécimen et présentez-le à l'adaptateur.
4. Appuyez sur **<OK>** afin de lancer l'aspiration du spécimen.
5. Retirez la seringue lorsque l'appareil vous y invite.
6. Confirmez ce retrait en appuyant sur **<OK>**.
7. Une fois la mesure terminée, lisez les résultats.
8. Tapez **<Home>** pour revenir à la page-écran **<Prêt>** ou **<Informations patient>** pour entrer en mémoire des informations patient.





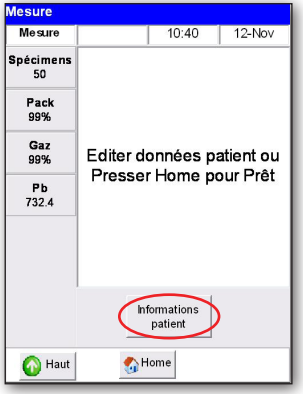

Tube capillaire

1. A partir de la page-écran **<Prêt>**, tapez **<Mesure spécimen>**.
2. Placez le tube capillaire à l'entrée de la cassette. Tenez le tube à l'horizontal.
3. Appuyez sur **<OK>** afin de lancer l'aspiration du spécimen.
4. Retirez le tube capillaire lorsque l'appareil vous y invite.
5. Confirmez ce retrait en appuyant sur **<OK>**.
6. Une fois la mesure terminée, lisez les résultats.
7. Tapez **<Home>** pour revenir à la page-écran **<Prêt>**.



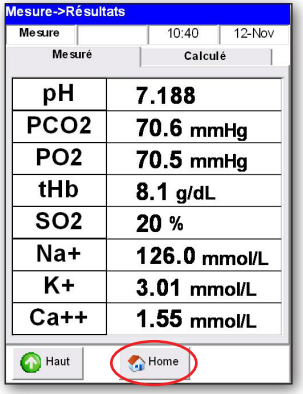

⚠ Consultez le Mode d'emploi ou le Manuel de Service de l'appareil pour instructions supplémentaires.

Remplacement des consommables

Remplacez la cassette

1. Ouvrez le couvercle et ôtez la cassette épuisée.
2. Jetez la cassette usagée en respectant la législation propre à votre pays.
3. Tapez **<Installer Cassette>** dans l'écran.
4. Lisez les deux codes à barres de la cassette.
5. Ouvrez la pochette, essuyez la caseette et installez-la sur la platine de mesure.
6. Fermez le couvercle afin de lancer le calibrage.
7. Consultez la fiche d'accompagnement pour instructions supplémentaires.



Remplacez le pack fluidique

1. Otez le pack usagé et remettez son multi-bouchon rouge.
2. Tapez **<Nouveau Pack>** dans l'écran.
3. Otez le multi-bouchon rouge du nouveau pack.
4. Installez le nouveau pack dans son logement.
5. Une fois le calibrage terminé, effectuez 2 niveaux de contrôle OPTI CHECK.
6. Consultez la fiche d'accompagnement pour instructions supplémentaires.



Remplacez la bouteille de gaz

1. Dévissez la bouteille usagée de son support (sens anti-horaire).
2. Tapez **<Bouteille de gaz neuve>** dans l'écran.
3. Lisez l'étiquette code à barres de la bouteille neuve et dévissez le bouchon plastique.
4. Insérez la bouteille dans son logement et vissez à fond dans le sens horaire.
5. Tapez **<Oui>** sur l'écran **<Nouvelle bouteille de gaz?>**, s'il s'agit d'une bouteille neuve.
6. S'il s'agit d'une bouteille usagée, tapez **<No>** et entrez le nombre de semaines d'utilisation.
7. Consultez la fiche d'accompagnement pour instructions supplémentaires.

Entretien

(Hebdomadaire) Nettoyage de l'appareil

1. Nettoyez la carrosserie à l'aide d'un chiffon de papier non pelucheux légèrement humidifié à l'eau.
2. Nettoyez la platine analytique avec un chiffon de papier non pelucheux imbibé d'alcool dilué ou d'un détergent usuel à base d'ammoniaque.

(Trimestriel) Mesure du Calibrateur

1. Sélectionnez **<Gestion système > Utilitaires>** et appuyez sur l'onglet **<Utilitaires>**.
2. Sélectionnez **<Calibrateur > Passer>**.
3. Suivez les instructions sur l'écran pour effectuer la mesure du calibrateur.
4. Une fois le calibrage terminé, tapez **<Home>** pour revenir à la page-écran **<Prêt>**.

NOTE: Il est recommandé de mesurer le calibrateur au moment du changement de la cassette afin d'éviter une usure prématurée de la cassette de mesure.

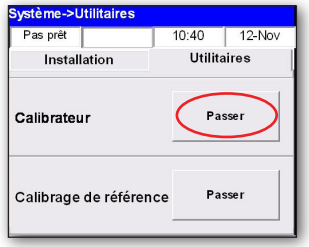

(Semestrielle) Remplacer la cartouche de pompe

1. Levez le couvercle de l'imprimante.
2. Tirez fermement la cartouche verticalement vers le haut et ôtez-la.
3. A la demande, ôtez les joints de pompe à l'aide d'une pince hémostatique ou une pince appropriée.
4. Jetez la pompe et les joints usagés en respectant la législation propre à votre pays.
5. Alignez l'axe femelle du tambour de la cartouche neuve avec l'axe mâle solidaire de l'appareil.
6. Poussez fermement l'ensemble vers le bas, en appuyant sur le tambour.
7. Ouvrez la platine de mesure et ôtez les joints d'étanchéité avec une petite pince.
8. Jetez les joints usagés en respectant la législation propre à votre pays.
9. Mettez en place les joints neufs (partie convexe en haut) et appuyez fermement.
10. Consultez la fiche d'accompagnement pour instructions supplémentaires.



Programmation Auto QC

1. Sélectionnez **<Gestion CQ>** dans l'écran **<Prêt>**.
2. Sélectionnez **<Auto QC>** sous **<Programmation>**.
3. Sélectionnez un intervalle de temps et appuyez sur **<Edit.>**.
4. Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'analyseur effectue le(s) contrôle(s) et appuyez sur **<OK>**.
5. Sélectionnez les niveaux de contrôle.
6. Programmez les autres intervalles de temps comme décrit ci-dessus.
7. Pour effectuer des mesures Auto QC le samedi et le dimanche appuyez sur la case d'option correspondante.
8. Appuyez sur **<Enregistrer>** pour entrer en mémoire les modifications.
9. Tapez **<Home>** pour revenir à la page-écran **<Prêt>**.